
Group hlagroup
Instrument AVX500
AVX500 1H
THS cP6T6 d2DCM Zn

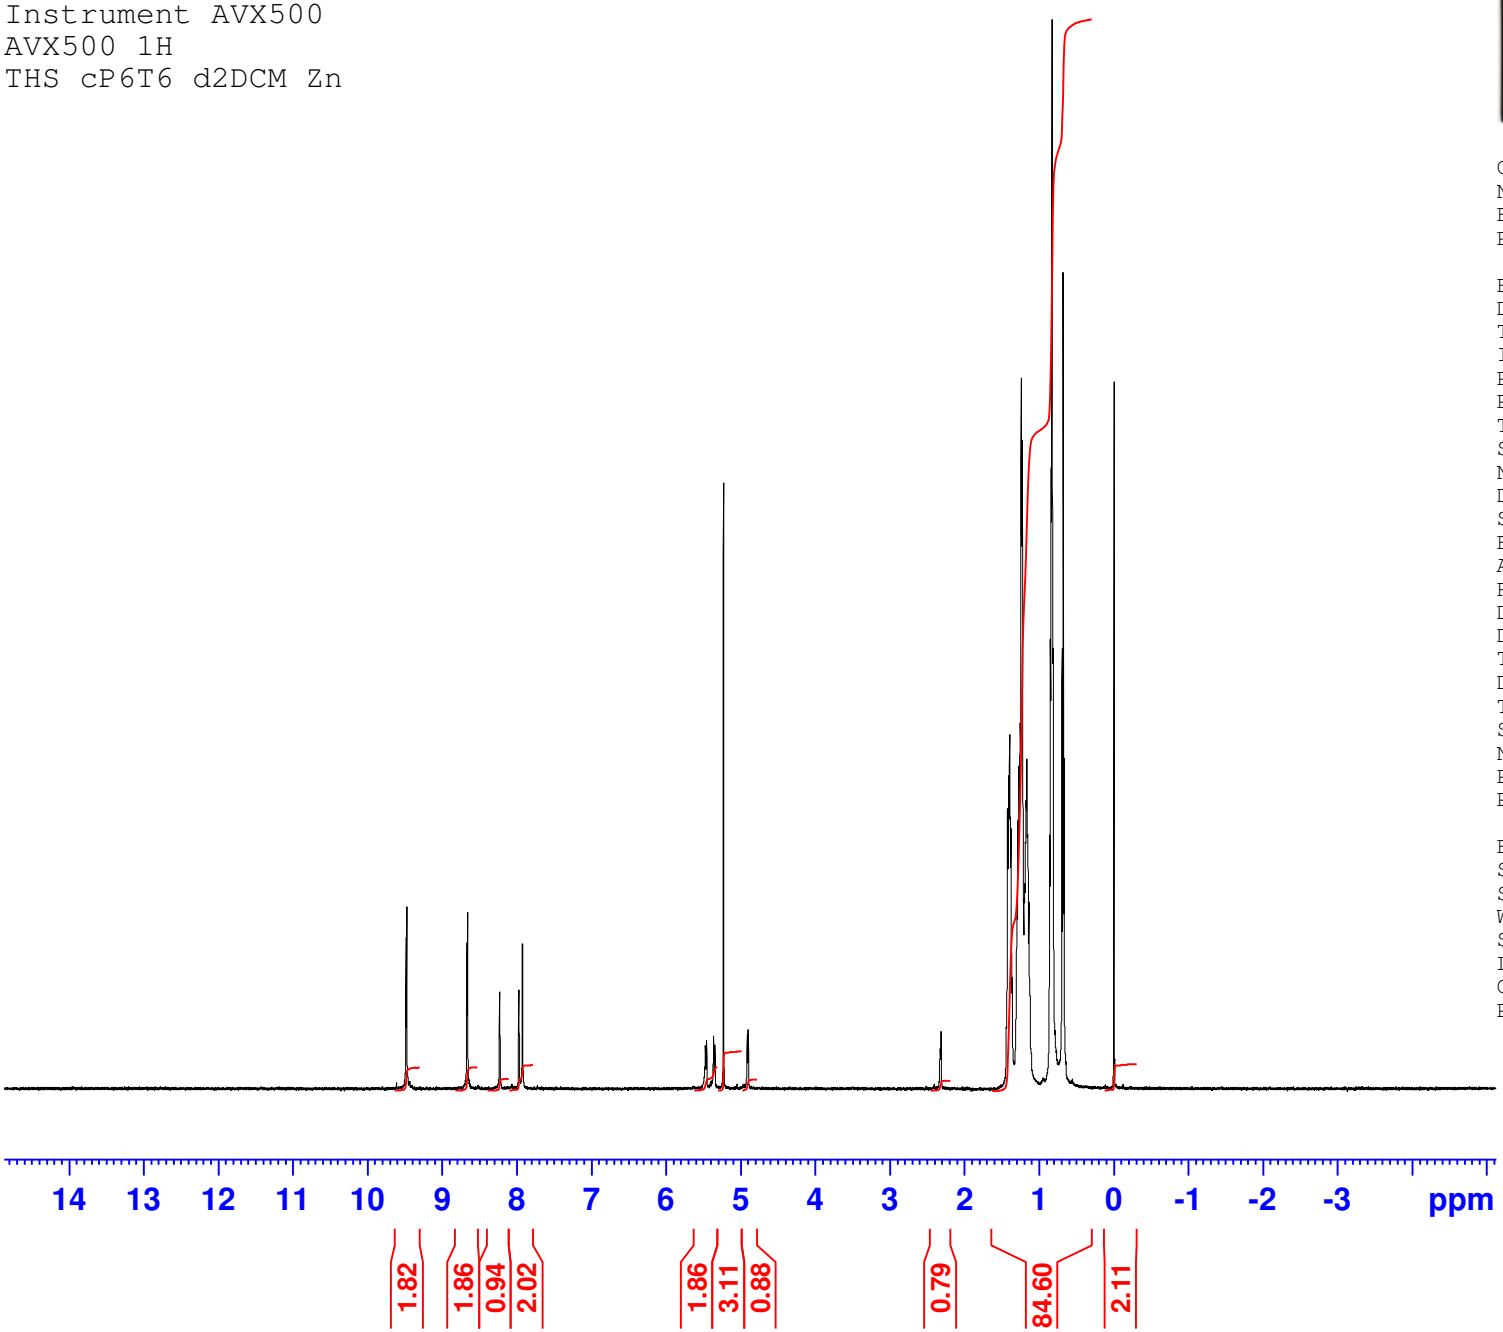

NMR@CHEM.OX

Current Data Parameters
NAME MP3-238-0
EXPNO 1
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20150505
Time 13.39 h
INSTRUM avx500
PROBHD Z113652_0208 (
PULPROG zg60
TD 65536
SOLVENT CD2Cl2
NS 16
DS 2
SWH 10000.000 Hz
FIDRES 0.152588 Hz
AQ 3.2767999 sec
RG 1.02
DW 50.000 usec
DE 6.50 usec
TE 298.0 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1
SFO1 500.1325007 MHz
NUC1 1H
P1 10.00 usec
PLW1 20.50000000 W

F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 500.1300616 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00